
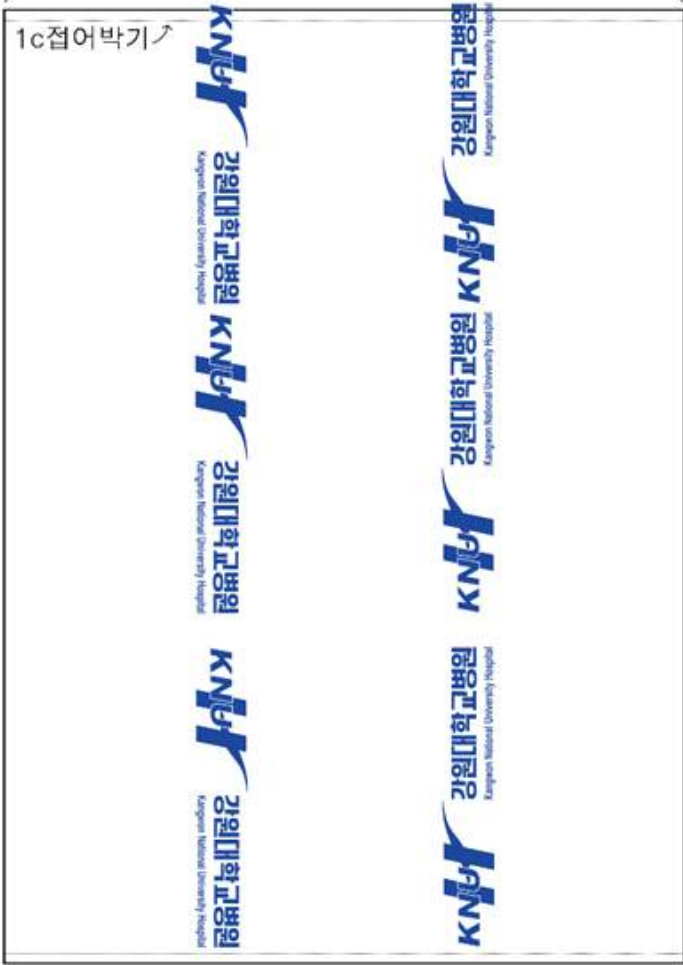

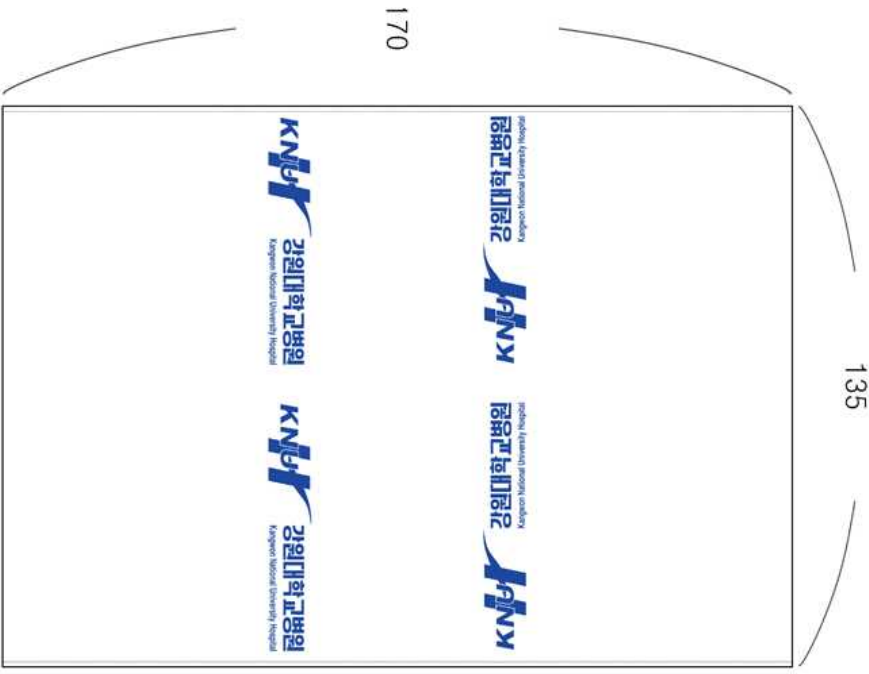




품명	대시트					
원단, 색상 및 무늬	면 100%, 10수 백색, 강원대학교병원 로고 나옴					
부자재	재봉사 40수 3합					
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	170	305				
제작방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 위아래는 1Cm 말아박기 봉제하고 좌우는 셀비지 그대로 마감처리한다. 2. 가운데를 45cm 띄워 두줄로 병원로고를 실크나옴한다. 					
납품 및 검수	<ol style="list-style-type: none"> 1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다. 					

<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>	<p>170Cm</p> <p>305Cm</p> 
	 <p>앞뒤 동일</p>
	<p>앞</p> <p>뒤</p>



품명	반시트					
원단, 색상 및 무늬	면 100%, 10수 백색, 강원대학교병원 로고 나염					
부자재	재봉사 40수 3합					
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	170	135				
제작방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 위아래는 1Cm말아박기 봉제하고 좌우는 셀비지 그대로 마감처리한다. 2. 가운데를 45cm 띄워 두줄로 병원로고를 실크나염한다. 					
납품 및 검수	<ol style="list-style-type: none"> 1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다. 					

<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>	
	<p>앞뒤 동일</p>
	<p>앞</p>

품명	배개솜					
원단, 색상 및 무늬	폴리에스테르 100%, 백색					
부자재	솜 재봉사 40수 3합					
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	60	40				
제작방법	1. 백색천에 솜 650g을 넣고 봉제한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

<p>제품모양 (도식화 및 전본품)</p>	<div> <div>60cm</div> <div>40cm</div>  </div>	
		<p>앞뒤 동일</p>
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>

품명	베개커버					
원단, 색상 및 무늬	레자, 갈색					
부자재	지퍼 60cm					
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	60	40				
제작방법	1. 가로방향으로 지퍼를 달아 마감한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

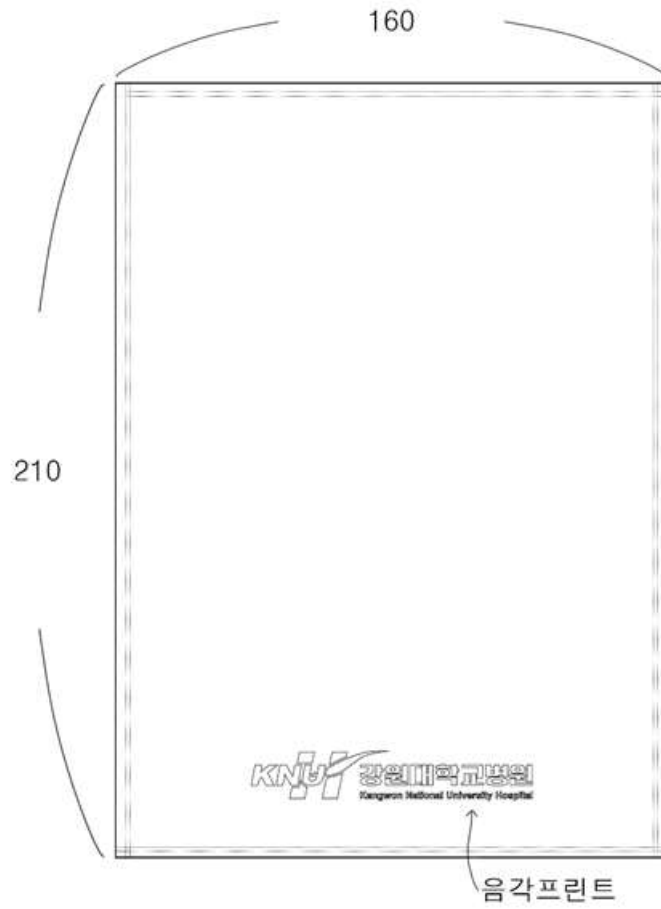
<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>	<p>60cm</p> <p>40cm</p> 	
		<p>앞 뒤 동일</p>
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>

품명	베개커버					
원단, 색상 및 무늬	면 100%, 10수, 백색					
부자재	재봉사 40수 3합					
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	80	50				
제작방법	1. 자루모양으로 박음질하고 입구는 2cm 말아박기 봉제한다. 2. 가운데 위치에 로고 실크나염프린트 한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>		
		<p>앞뒤 동일</p>
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>

품명	담요					
원단, 색상 및 무늬	폴리에스테르 100%, 초록색					
부자재						
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	160	210				
제작방법	1. 직사각형태의 홀겹 담요 2. 4면을 1“씩 접어 1/4“ 간격으로 두줄 스티치한다. 3. 하단 중앙에 음각으로 로고를 새긴다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

제품모양
(도식화 및
견본품)



앞

뒤

품명	베개커버(특실용)					
원단, 색상 및 무늬	T/C 5도 스트라이트 원단(앞면, 뒷면)					
부자재	재봉사 40수 3합					
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	70	50				
제작방법	1. 4면을 1/2" 바이어스처리(제원단)한 얇게 누빈 베개패드 2. 오른쪽 상단에 로고 자수프린트					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

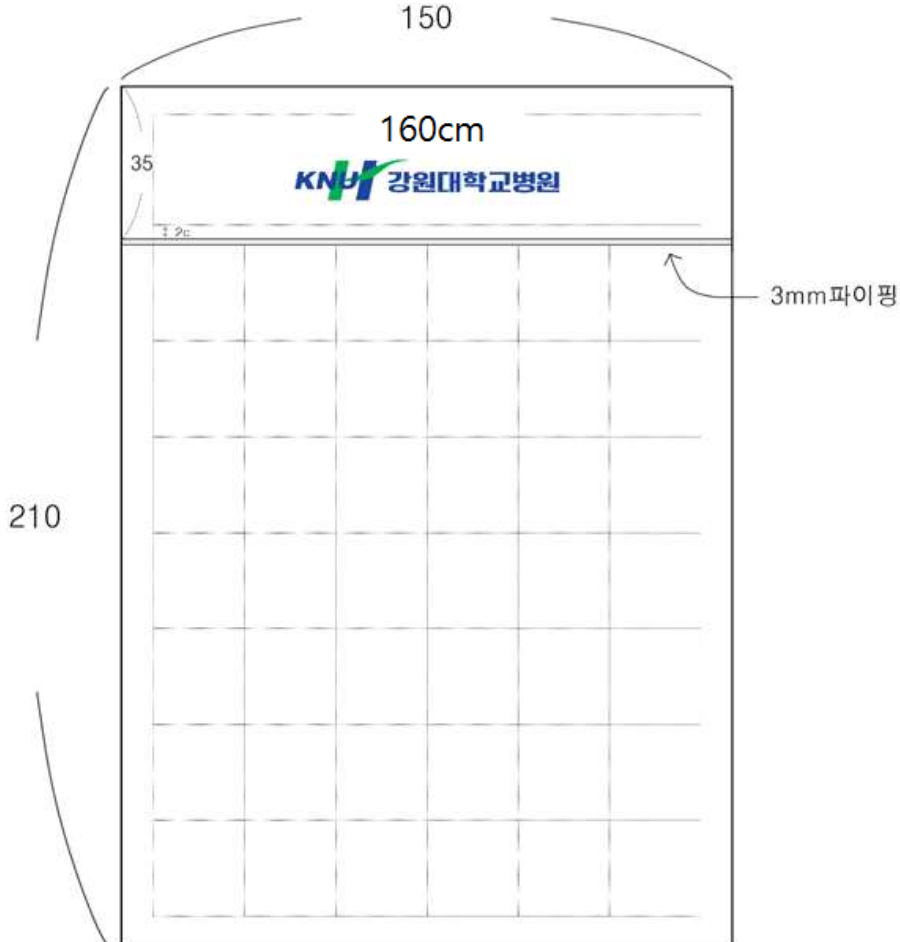

제품모양
(도식화 및
견본품)








앞

뒤

품명	이불					
원단, 색상 및 무늬	T/C 5도 스트라이트 원단(앞면, 뒷면)					
부자재	파이핑 3mm					
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	160	210				
제작방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직사각형태의 사각누빔 차렵이불 2. 위솔기선에서 35CM아래 위치에 파이핑물려 봉재하고 위쪽 가운데 부분에 로고를 자수처리한다. 					
납품 및 검수	<ol style="list-style-type: none"> 1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다. 					

<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>		
		<p>앞뒤 동일</p>
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>



품명	특실 이불					
원단, 색상 및 무늬	면 60수					
부자재	에어론(폴리100%), 솜 두께 14oz					
규격 (단위: cm)	가 로	세 로				
	160	220				
제작방법	1. 직사각형태의 이불 2. 위솔기선에서 15CM 4면 테두리 봉제하고, 위쪽 가운데 부분에 로고를 자수처리한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>		
		
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>

품명	인공신장실 침대 패드					
원단, 색상 및 무늬	T/C 핑크색					
부자재	핑크색 T/C 186 44"					
규 격 (단위: cm)	가 로	세 로				
	110	175				
제작방법	1. 직사각형태의 얇게 누빔처리된 패드 2. 오른쪽 하단에 로고자수된 띠를 덧댐 3. 4면 제천바이어스 처리함					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>		
		<p>앞뒤 동일</p>
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>

품명	인공신장실 베개 커버					
원단, 색상 및 무늬	T/C 핑크색					
부자재	핑크색 T/C 186 44”					
규격 (단위: cm)	가로	세로				
	60	50				
제작방법	1. 4면을 1/2 바이어스처리 (제원단)한 얇게 누빈 베개패드					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>		
		<p>앞뒤 동일</p>
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>